Wagen E 941/1 zur Aufnahme von Modulen

Miele PROFESSIONAL

Lieferumfang:

Grundwagen E 941/1 zur Aufnahme von Modulen, H 421, B 619, T 790 mm
mit einer Magnetleiste für die automatische Wagenkennung

⚠ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung der Reinigungs- und Desinfektionsautomaten G 7827/28 oder PG 8527/28.
Bei Nutzung der automatischen Wagenkennung muss die Kodierung angepasst sein!

Anwendungsgebiet:

In den Wagen E 941/1 können Module für Laborglas oder für Instrumente aus der orthopädischen Chirurgie eingesetzt werden.
Den Modulen liegen separate Gebrauchsanweisungen bei.

Abhängig von der Größe des Spülgutes sind bis zu vier Module gleichzeitig einsetzbar.

Kontrollieren Sie bei der Beladung / vor jedem Programmstart:

- die Funktionsfähigkeit der Verschlussklappen in den Modulankopplungen,
- die Ankopplung der eingesetzten Module an die Wasserversorgung des Wagens,
- die Ankopplung des eingeschobenen Wagens an die Wasserversorgung des Reinigungs-/Desinfektionsautomaten.

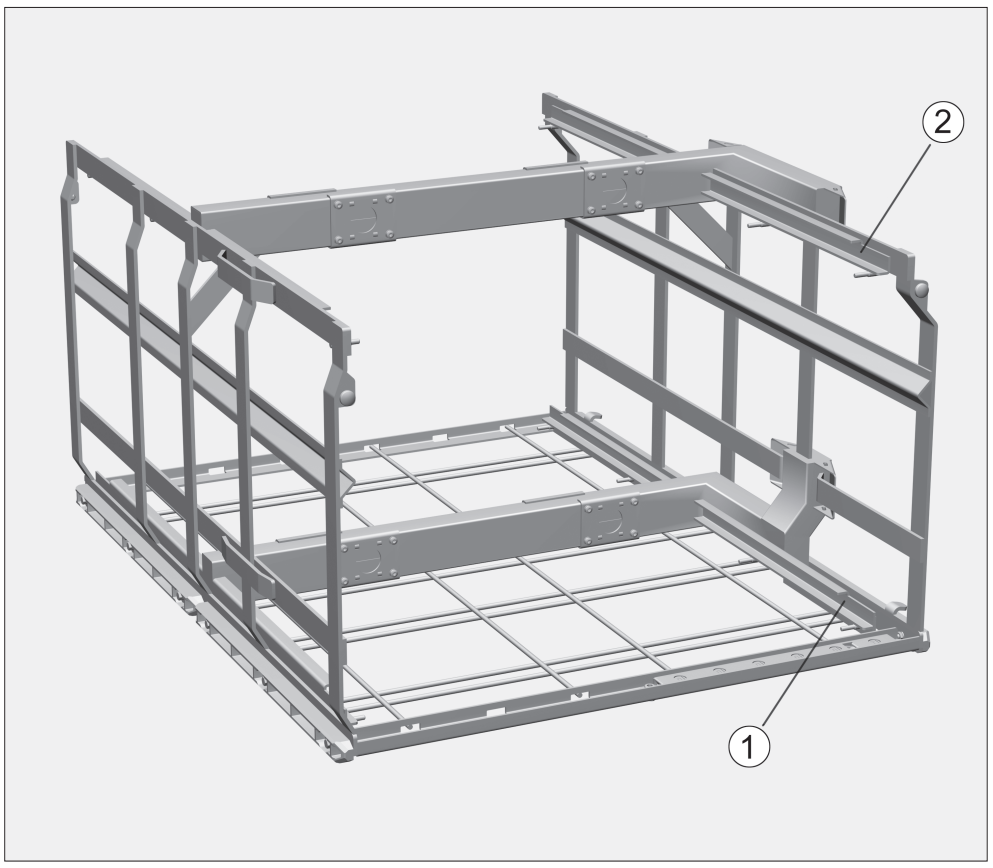

Module in den Wagen einsetzen

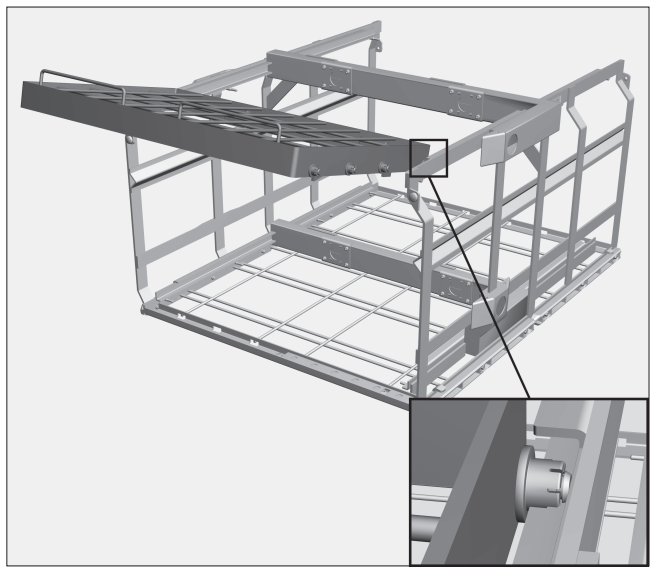

- Die Laufrollen des Moduls auf die Führungsschiene aufsetzen, die gefederten Wasserzuführungen zeigen zur Wagenmitte.
- Das Modul vollständig in den Wagen schieben.

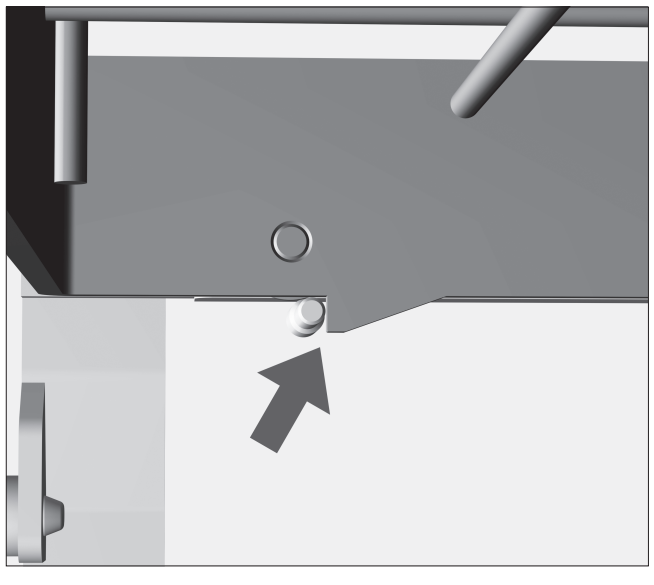

Die Rasthaken an der Unterseite des Modulrahmens greifen auf beiden Seiten hinter die Stifte an der Führungsschiene des Wagens.

Das Modul muss spürbar einrasten, damit es richtig positioniert ist.

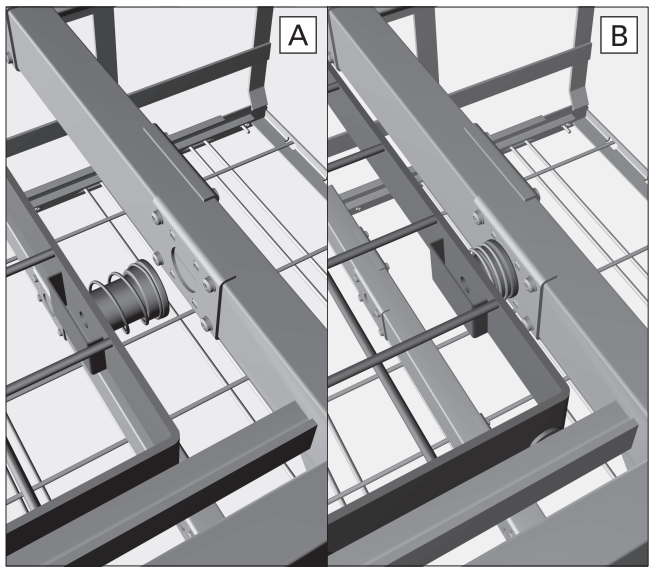

Bei Modulen mit integriertem Wasseranschluss wird die Wasserzuführung durch die richtige Position des Moduls sichergestellt.

Module aus dem Wagen zu entnehmen

- Das Modul an den Griffen anheben, bis der Rasthaken über die Stifte nach vorn gleiten kann.
- Danach das Modul aus der Führungsschiene herausziehen.

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany, Telefon (05241) 89-0, Telefax (05241) 89 14 50,
Internet: http://www.miele-professional.de / CE 0297 Änderungen vorbehalten / Erstelldatum: 2015-11-01

M.-Nr. 10 332 390 / 00 de