Filteradapter E 478/1 med mikrofilter

Leverancen omfatter:

Filteradapter E 478/1 udstyret med:
- 4 skyllekanaler til luer-lock ♂
- 1 filterplade i rustfrit stål
- 4 afdækningskapper E 531 til luer-lock

Ekstraudstyr
- E 448, silikoneslange 300 mm med luer-lock-adapter ♂ til luer-lock ♀
- E 362, blindskrue
- Forbindelsesstykker E 790 luer-lock ♀ / luer-lock ♀

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningerne til rengørings- og desinfektionsmaskinen og til injektorvognen skal overholdes. Der må kun rengøres kanyler/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinrengøring. Følg de specifikke rengøringsråd, især mht. påkrævet filtreringsgrad. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet.

Anvendelsesområde

Filteradapter E 478/1 kan anvendes i injektorvogne til øjenkirurgi-instrumenter. Der følger en separat brugsanvisning med injektorvognene.
Med filteradapter E 478/1 kan særligt snæverhalsede skylle- og sugehåndtag og snæverhalsede kanyler, f.eks. Sauter-kanyler, rengøres.
Den anvendte filterplade med en udskilning ≥ 0,1 mm forhindrer, at partikler fra vandet tilstopper lumenerne.

Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt ved valideringen.

Kanylerne og andre hulrumsinstrumenter skal hurtigst muligt efter anvendelsen på patienter, helst allerede i OP, spules med en sprøjte med vand. Hermed forhindres, at blodrester eller rester fra de anvendte medikamenter tilstopper de snævre lumener og dermed vanskeliggør den indvendige rengøring.

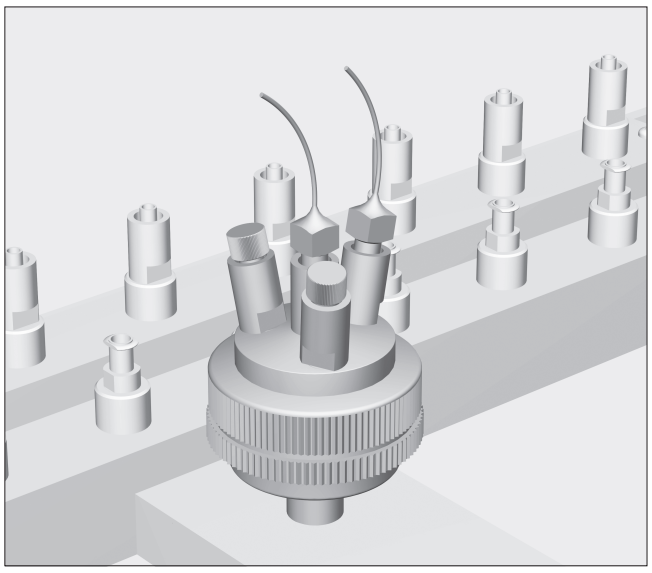

Kanyler rengøres

- Kanylerne skrues på luer-lock-skyllekanalerne på E 478/1.
- Tilslutninger, der ikke anvendes, skal lukkes med en afdækningskappe E 531!

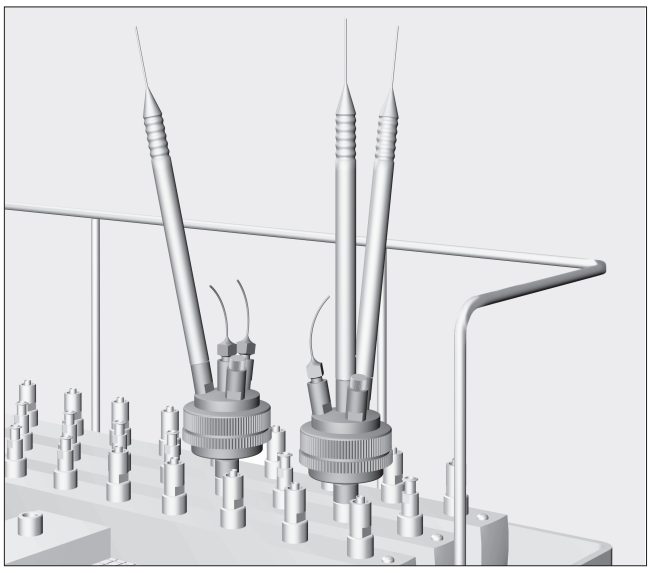

Snæverhalsede instrumenter rengøres

Instrumenter med én tilslutning:

- Instrumenterne tilsluttes til luer-lock-skyllekanalerne på E 478/1.
- Mellem instrumenter med han-luer-lock-tilslutning og luer-lock-skyllekanalen anvendes et forbindelsesstykke E 790 luer-lock ♀ / luer-lock ♀.
- Tilslutninger, der ikke anvendes, skal lukkes med en afdækningskappe E 531!

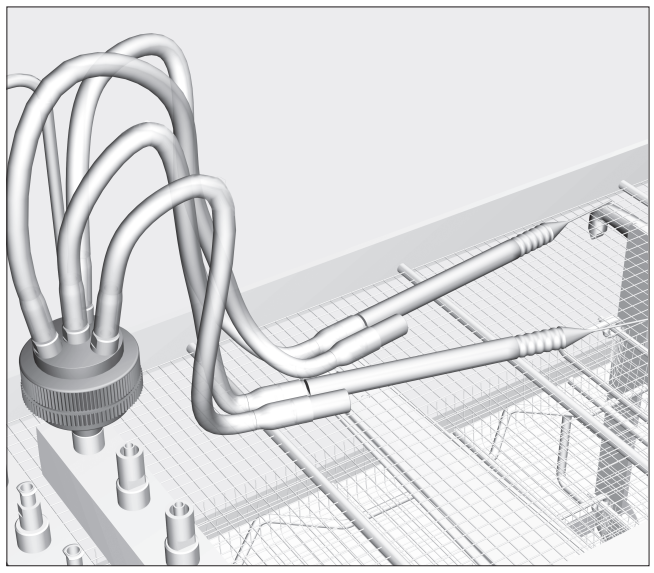

Instrumenter med flere tilslutninger:

- Skru luer-lock-skyllekanalerne af (skruenøgle SW 7), erstat dem med silikoneslanger E 448, og stram disse (skruenøgle SW 9).
- Hver af instrumentets tilslutninger, f.eks. skylle- og sugehåndtag, forbindes med en slangetilslutning E 448.
- Mellem instrumenter med han-luer-lock-tilslutning og slangetilslutning E 448 anvendes et forbindelsesstykke luer-lock ♀ / luer-lock ♀.

Hulrumsinstrumenterne skal fastgøres på injektorvognens holdegitter. Dette er beskrevet i brugsanvisningen til injektorvognen.

Slangetilslutninger, der ikke anvendes, erstattes med en blindskrue E 362.

Kontrol som led i kvalitetssikring

Kanyler og hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra adapterne under rengøringen, skal rengøres på ny.

- Efter rengøringen skrues hulrumsinstrumenterne eller kanylerne af, og det resterende vand blæses ud med medicinsk trykluft. Hermed kontrolleres samtidig, at de ikke er tilstoppede.
- I givet fald kan pH-værdien af de udtrængende vanddråber kontrolleres med indikatorpapir (deling ≤ 0,5).

Ved negativt kontrolresultat:

- I tilfælde af tilstoppelse eller begrænset gennemgang fjernes den pågældende partikel eller rest manuelt.

Herefter, også ved en pH-værdi, der afviger fra den neutrale værdi:

- rengøres kanylerne endnu en gang.

Hvis pH-værdien igen afviger fra den neutrale værdi, kontaktes Miele Teknisk Service for analyse og afhjælpning af problemet.

Miele A/S, Erhvervsvej 2, Postboks 1371, DK-2600 Glostrup, Tlf. 43 27 11 00, Miele Teknisk Service telefax 43 27 13 09,
Internet: www.miele.dk / CE 0297 Ret til ændringer forbeholdes / Oprettelsesdato: 07.02.2012

M.-Nr. 10 338 580 / 00 da

Filteradapter E 478/1 med mikrofilter

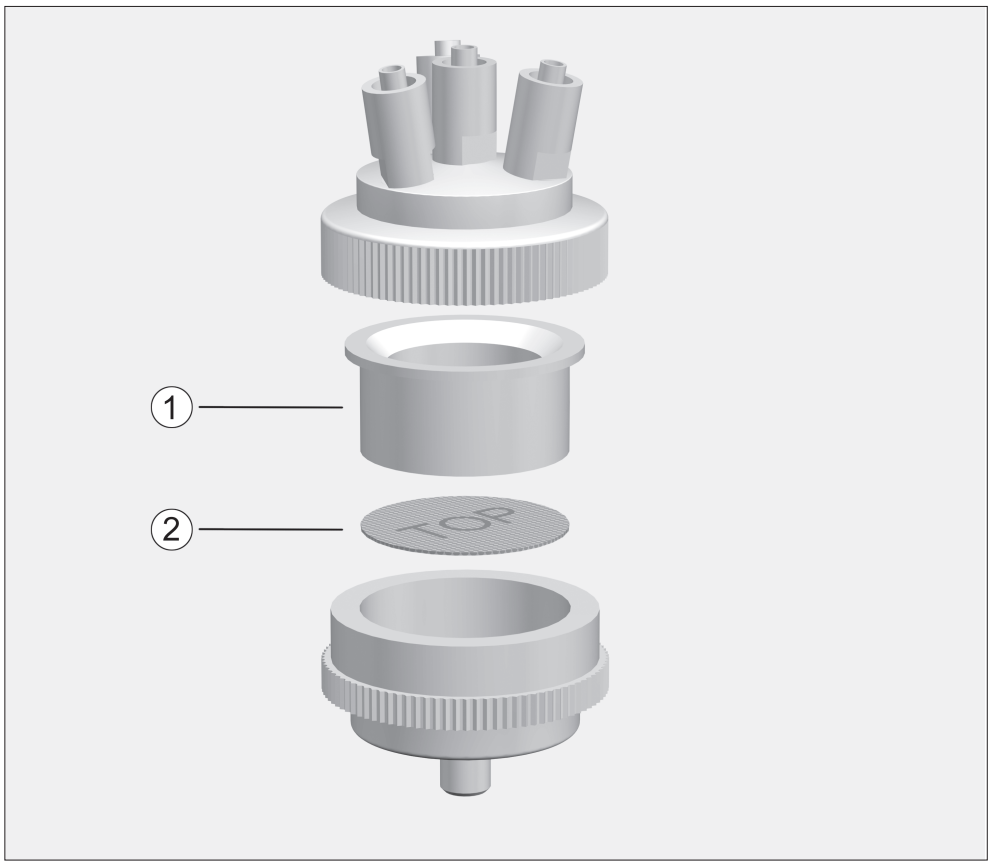

Filterpladen i rustfrit stål rengøres

Filterpladen skal rengøres **mindst en gang om dagen**, hvis der udelukkende rengøres oftalmologiske instrumenter i rengørings- og desinfektionsmaskinen.

Filterpladen skal rengøres før hver kørsel med oftalmologiske instrumenter, hvis der er øget risiko for tilsmudsning, f.eks. hvis der forinden er rengjort instrumenter fra andre anvendelsesområder.

Fremgangsmåde:

- Skru filteradapteren af injektorvognen.
- Skru filteradapterens over- og underdel fra hinanden.
- Tag silikoneadapteren ① og filterpladen ② ud af underdelen.
- Skyl adapterens underdel og filterpladen ② under rindende vand, og rengør delene med en blød børste.

Efter rengøringen skal det kontrolleres, om:

– filterpladen ser helt ren ud,

– filterpladens huller er beskadigede.

⚠ Der må under ingen omstændigheder anvendes filterplader med synligt snavs. Hermed sikres gennemskylningen af snæverhalsede instrumenter ikke.
Beskadigede filterplader må ikke længere anvendes. Filtreringsevnen er reduceret, og de snæverhalsede instrumenter kan blive tilstoppede.
Fjern beskadigede eller snavsede filterplader, og udskift dem med en ny.

- Filterpladen med påtrykningen **TOP** anbringes opad i adapterens underdel. Den skal ligge præcist på den ringformede holder i adapterens underdel.
- Sæt silikoneadapteren ① ind i underdelen, og skru adapterens over- og underdele sammen.
- Skru filteradapteren på injektorvognen.